



& CATARACT REFRACTIVE

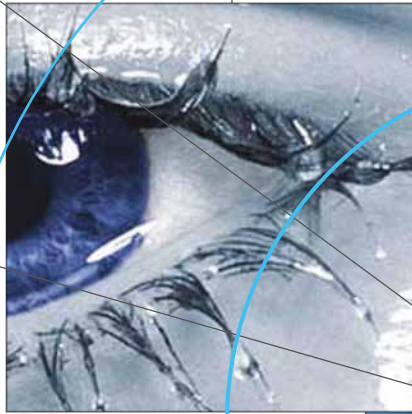

**we elaborate Concepts
to give a clearer Vision**

e. *janach*®

SPECULUMS




Lieberman J2031.12

Blefarostato regolabile in titanio, valve aperte da 13 mm
Titanium adjustable speculum, 13 mm open blades





Janach J2031.13

Blefarostato regolabile in titanio, valve aperte **anatomiche** da 13 mm
Titanium adjustable speculum, 13 mm **anatomic** open blades



Janach J2031.14

Blefarostato regolabile **nasale** in titanio, valve aperte **anatomiche** da 13 mm
Adjustable **nasal** speculum, 13 mm **anatomic** open blades




Buratto J2031

Blefarostato regolabile, valve aperte 14 mm, **anatomiche**
Adjustable speculum, 14 mm **V-shaped anatomic blades**



Buratto J2032


Blefarostato regolabile, valve piene 15 mm, **anatomiche**
Speculum, solid blade, for LASIK, 15 mm **anatomic blades**



Janach J2033


Blefarostato regolabile, valve aperte 16 mm, con **aspirazione**
Adjustable **aspirating** speculum, 16 mm blades

aspirating



Pinza capsuloressi per MICS, cross action, manico ergonomico lunghezza branche **11 mm**, apice ovale, per incisione da **1.5 mm**, titanio



MICS capsulorrhesis forceps, cross action, ergonomic handle **11 mm** long tips oval shaped, for **1.5 mm** incisions, titanium



Inamura J3126.7

Pinza capsuloressi per MICS, cross action, manico ergonomico lunghezza branche **11 mm**, per incisione da **1.7 mm**, titanio


MICS capsulorrhesis forceps, cross action, ergonomic handle **11 mm** long tips, for **1.7 mm** incisions, titanium




Inamura J3126.6

Pinza capsuloressi per MICS, cross action, manico ergonomico lunghezza branche **10 mm**, per incisione da **1.7 mm**, titanio

MICS capsulorrhesis forceps, cross action, ergonomic handle **10 mm** long tips, for **1.7 mm** incisions, titanium



CONTROLLEDopening



Giannetti J3135.1



Pinza capsuloressi per MICS con apertura controllata, apice ovale per incisione da **1.8 mm**
MICS capsulorrhesis forceps with controlled opening oval shaped tips, for **1.8 mm** incisions

riferimenti sul dorso per la misurazione della ressi/reference marks to gauge the rhexis (5.0 mm - 6.0 mm)



Crozafon® J3141

Pinza capsuloressi per faco-microcoaxial con apertura controllata, per incisione da **1.8 mm**
Capsulorrhesis forceps for microcoaxial phaco with controlled opening tips, for **1.8 mm** incisions




D. Surace J3135.4

Pinza capsuloressi MICS con apertura controllata, per incisione da **2.2 mm**
MICS capsulorrhesis forceps with controlled opening tips, for **2.2 mm** incisions

riferimenti sul dorso per la misurazione della ressi/reference marks to gauge the rhexis (5.0 mm - 5.5 mm - 6.0 mm)



CONTROLLED opening



Pinza capsuloressi per MICS con apertura controllata, apice ovale per incisione da 2.2 mm, manico piatto in titanio



MICS capsulorrhesis forceps with controlled opening oval shaped tips, for 2.2 mm incisions, titanium flat handle



Ligabue J3125.2

Pinza capsuloressi per MICS con apertura controllata, punta acuta, per incisione da 2.5, manico piatto in titanio



MICS capsulorrhesis forceps with controlled opening tips, for 2.5 mm incisions, titanium flat handle

COAXIAL capsulorrhesis



Pinza per capsuloressi coassiale 23G per MICS, punte 1.3 mm, per incisione da 1 mm, manico in titanio



MICS coaxial capsulorrhesis forceps 23G, 1.3 mm long tips, for 1 mm incisions, titanium squeeze handle



L. Curbelo J3137.6

Pinza per capsuloressi, 23G, coassiale per MICS, per incisione da 1 mm, manico in titanio



MICS coaxial capsulorrhesis forceps 23G, 1.0 mm long tips, for 1 mm incision titanium squeeze handle



Caporossi J3124.1L

Pinza capsuloressi coassiale per MICS, gambo rastremato 21-27G, apici smussi, per incisione da 0.5 mm



MICS coaxial capsulorrhesis forceps, tapered shaft 21-27G, blunt tips for 0.5 mm incision

PRE-OPERATIVE

pendulum swinging system markers

Elies J2281.1

Marcatore assiale, per la marcatura asse orizzontale/toriche, consente **4 impronte** di marcatura preoperatoria


Axial marker, for horizontal/toric axis marking, allows **four pre-operative** marking imprints

· With the horizontal axis marker fixed, the toric axis marker can be rotated and fixed at the requested angle with a **5° step** mechanism, thus providing in one step both, horizontal and toric axis marking.

· Pendulum swinging system assures precise horizontal axis.
· One-step marking of 2 axis: horizontal and toric

I sistemi a pendolo richiedono una corretta posizione del paziente seduto alla lampada a fessura.
The pendulum systems device require a correct position of the patient sitting at the slit lamp.

(based on Elies M.D. model)



Fazio J2281.3

Marcatore assiale con mirino di centraggio, asse orizzontale effettuato con impronta epiteliale.

Telaio curvo per una migliore visibilità durante la procedura di marcatura

Axial marker with eye centering device, horizontal axis performed by marking epithelium imprint. Curve Shaped for better visibility during the marking procedure



Buratto J2283.1

Marcatore assiale orizzontale per lampada a fessura da utilizzare con supporto (staffa) **J2283**

Slit lamp mounted axial marker, for patient seated at the slit lamp to be used with support **J2283**

Permette due impronte di marcatura **0°-180°**
Il sistema montato alla lampada a fessura, assicura una perfetta marcatura dell'asse orizzontale

Allows two precise marking imprints **0°-180°**
Slit lamp mounted system assures perfect horizontal axis marking

Buratto J2283

Supporto da lampada a fessura per marcatore assiale **J2283.1** e **J2283.2**

Support for slit lamp mounted axial marker
To be used with **J2283.1** and **J2283.2**



Ligabue J2283.2

Marcatore assiale orizzontale per lampada a fessura, con bolla di livello per un corretto fissaggio, da utilizzare con supporto (staffa) **J2283**

Esegue due impronte di marcatura **0°-180°**

Effettua la bilanciatura della bolla, l'asse viene bloccato attraverso la vite di fissaggio, evitando sgradevoli tolleranze negative causate dal contatto delle punte sull'occhio del paziente (tilting)

Slit lamp axial marker, with bubble level, to be used with support **J2283**

Allows two precise marking imprints **0°-180°**


Slit lamp mounted system assures perfect horizontal axis marking
Once the bubble level is balanced, the perfect horizontal alignment marker must be fixed acting on the screw

The device avoids negative tolerances caused by contact of the tips on the eye (tilting)

Janach J2007

Blefarostato con valve aperte da **15 mm**.
Consigliato per uso diagnostico e chirurgico.
L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente

Wire speculum **15 mm** long blade with large frame.
Recommended for diagnostic and surgical procedures.
The wide frame allows easy placement and removal.




INTRA-OPERATIVE markers

Ligabue J2294.55

Marcatore assiale Torico con misuratore per capsuloressi \varnothing 5.5 mm.

da utilizzare con l'anello di Mendez **J2294.5** e con il **nuovo anello calibrato Ligabue J2294.56**

Permette di fissare l'asse torico, lasciando contemporaneamente una precisa marcatura a spot per la ressi




rhexis reference spots

Toric axial marker and capsulorrhexis gauge \varnothing 5.5 mm.

Recommended use with Mendez ring **J2294.5** and **new Ligabue gauge ring J2294.56**

It allows to fix the toric axis and leaves a precise marking spot simultaneously.

Useful to perform the recommended **5.5 mm** capsulorrhexis for toric IOL implantation



Ligabue J2294.56

Nuovo anello calibrato, con step da 5° , di forma anatomica avvolgente, superiore ed inferiore.


La doppia svasatura conferisce perfetta adesione e minima invasività dovuta all'assenza di spigoli a contatto.

La svasatura superiore permette inoltre una più chiara visione anche in occhi piccoli facilitando l'inserimento del marcatore dell'asse torico **J2294.55**

New gauge ring, with marks each 5° , with double flared upper and lower.

The lower flared ring grants minimal invasivity due to the absence of edges in contact with the patient's eye.

The upper flared ring allows a clearer and better vision of the 5° marks and significantly improves the insertion of the new toric axis marker **J2294.55**



Set Toric IOL

5 set per box

Ogni set è composto da **anello + marcatore assiale**


Toric IOL set now available

5 sets per box

Each set is composed of **ring + axial marker**

Caratteristiche principali:

- . anello marcatore con step da 5°
- . marcatore assiale orizzontale, può essere utilizzato anche senza penne dermografiche, imprime sull'epitelio due delicate marcature



JCP0003 Disposable TORIC IOL SET

5 sets per box



Main Features:

- . ring marker with marks each 5°
- . horizontal axial marker can be also used without the marking pens, it leaves two soft marking imprints on the epithelium



I/A CANNULAE coaxial


J2239.30

Manico ergonomico per cannule I/A Ergonomic handle for I/A cannulas



J2239.31

I/A cannula, diritta
I/A cannula, straight




da usare **senza** lo sleeve in silicone
to be used **without** the silicone sleeve



J2239.32


I/A cannula, angolo di 45°
I/A cannula, angled 45°



★ most popular


J2239.33

I/A cannula, angolo di 90°
I/A cannula, angled 90°




J2239.35

I/A cannula, curva
I/A cannula, curved




J2239.34

I/A cannula, punta 150° curva ad uncino per ore 12
I/A cannula, tip 150° hook-shaped



J2239.30


Manico ergonomico per cannule I/A Ergonomic handle for I/A cannulas



J2239.36

MICS I/A cannula con angolo 45°, per 2.2 millimetri di incisione
da utilizzare con lo sleeve in silicone (J2239.10)

MICS I/A cannula angled 45°, for 2.2 mm incisions
use with silicone sleeve (J2239.10)



J2239.10



Sleeve in silicone, confezione 5 pz. non sterile,
da utilizzare con la cannula J2239.36


Silicone Sleeve package 5 pc. non-sterile,
to be used with J2239.36 cannula



I/A bimanual thin CANNULAE


Janach J2233.21

Cannula aspirazione curva, sottile, Ø 22G, punta sabbata, foro di aspirazione 28G, manico in titanio
New aspirating handpiece, Ø 22G, curved, THIN sandblasted tip, 28G top port, titanium handle



Janach J2233.22

Cannula infusione, curva, sottile, Ø 22G, a due fori laterali irriganti da 26G, manico in titanio
New irrigating handpiece, Ø 22G, curved THIN tip, dual 26G side ports, titanium handle




C. Magni J2192.41A

Cannula infusione curva, da 23G, apice push-pull, per la manipolazione e posizionamento di tutte le IOL toriche e non.
può essere utilizzato per la chirurgia intra-operatoria in miopia nella cataratta bi-manuale

23G push-pull manipulator cannula, blunt tip, for toric and non-toric IOL monomanual rotation and positioning.
It can be used for intra-op myopia in bi-manual cataract surgery



FEMTO LASER cataract



Crozafon® J3647.4



Crozafon® Prechopper per tecnica Ultrachopper™ con femto laser apertura 2 mm, branche ultra sottili
Crozafon® Prechopper for Ultrachopper™ and femto laser surgery technique, 2 mm opening, ultra-thin blades



Crozafon® J2192.17A



Crozafon® splitter per nucleo, di forma a disco, sottile, per femto laser (utile per separare le porzioni di nucleo)
Crozafon® nucleus splitter, disc shaped very thin for femto second laser (useful to separate the nucleus portions)



Minoru Tomita J2192.91A



Dissettore per tasca intrastromale. Il particolare design con curvatura e sottigliezza del dissettore consente una delicata dissezione della tasca evitando stress dell'incisione principale
Intrastromal pocket dissector. The unique design, curvature and thickness of this dissector allows comfortable dissection. Of the pocket without stressing the incision.



Buratto J2192.35A




Micro spatola sottile a lancia, larghezza 0.8 mm, per scollare ed aprire delicatamente le incisioni create dal femto laser
Incisions breaching spatula for femto laser procedure, 0.8 mm lanced shaped (to open the incision performed by femto laser)



Janach J2641.30



Micro cannula da 0.4 mm, per idro-cracking e separazione del nucleo in chirurgia con femto laser
Hydro-cracking micro cannula, 0.4 mm, for nucleus splitting in surgery with femto laser



Janach J3126.9




Pinza stripping per MICS, cross action, punte smusse da 11 mm, per incisione da 1.7, titanio
(per afferrare e rimuovere il flap capsulare nella chirurgia con femto laser)
MICS stripping forceps, cross action, 11 mm blunt tips, for 1.7 incisions titanium, blunt tips (to grasp and remove the lens capsule after femto laser capsulotomy)



Buratto J3137.7



Pinza MICS stripping coassiale 23G per rimuovere il flap capsulare nella chirurgia con femto laser
23G Coaxial stripping forceps (to grasp and remove the lens capsule after femto laser capsulotomy)



Janach J2115.18A

Strumento con doppio terminale, per scollare e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. L'uncino delicato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap. L'ansa allungata a forma di "C" e rastremata viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)



Double-ended instrument to unstick and lift the corneal flap in LASIK procedures. The delicate hook works at the flap edges inside the groove. The "C" shaped tapered loop, once positioned below the flap, lifts it with a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the exit point)




Scaroni J2199.20A

Strumento con doppio terminale rastremato, per scollare e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. L'apice leggermente angolato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap. Il secondo terminale lineare e rastremato viene posizionato sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)




Double-ended instrument tapered tips to unstick and lift the corneal flap in LASIK procedures. The angled tapered tip works at the flap edges inside the groove. The linear tapered tip, once positioned below the flap, lifts it under a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the point of exit)



Buratto J2114.16A

Strumento con doppio terminale, per scollare e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. L'uncino delicato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap. Il terminale a forma di lancia sottile e delicata viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)




Double-ended instrument to unstick and lift the corneal flap in LASIK procedures. The delicate hook works at the flap edges inside the groove. The lanced shaped tip, once positioned below the flap, lifts it under a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the point of exit)




Pinelli J2114.10A

Strumento con doppio terminale, per scollare e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. L'apice angolato delicato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap. Il terminale rastremato viene posizionato sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)




Double-ended instrument to unstick and lift the corneal flap in LASIK procedures. The delicate angled tip works at the flap edges inside the groove. The tapered straight tip, once positioned below the flap, lifts it under a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the point of exit)



Pinelli J2114.11A

Strumento con doppio terminale rastremato, per sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. Gli apici rastremati hanno lunghezza e angolazione differente. Il terminale più corto e meno angolato viene utilizzato per l'accesso nasale, mentre quello più lungo e più angolato viene utilizzato per l'accesso temporale. I terminali posizionati sotto il flap scollano e sollevano sotto un'azione di spinta il flap lungo il piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)



Double-ended instrument to lift the corneal flap in LASIK procedures. The delicate tapered tips have different lengths and angles. The shortest tip, less angled, is used for temporal access, while the longest tip, with wider angle, is used for nasal access. Both tips, once positioned below the flap, lift it under a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the point of exit)

Buratto J2114.1A



Spatola sottile e delicata per sollevamento e posizionamento del flap corneale per tecnica LASIK
 LASIK spatula delicate for lifting and repositioning the corneal flap



Buratto J2114.15A



Strumento con doppio terminale, per scollare e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. L'uncino delicato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap. Il terminale piatto viene posizionato sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta attraverso il lato più sottile della spatola (dalla cerniera fino al punto d'uscita)



Double-ended instrument, to detach and lift the corneal flap in LASIK technique. The delicate hook is inserted into the groove to detach the flap edge. The flat ended tip is positioned under the flap and lifts it with a gentle push provided by the thinner side of the spatula (from hinge to the exit point).

Janach J2114.2A



Spatola protettore del epiflap in tecnica LASIK. Il gradino della spatola viene posizionato lungo la cerniera del flap corneale una volta sollevato. Svolge un'azione di protezione dell'epiflap durante il trattamento



Epiflap protector spatula for LASIK technique. The edge of the spatula is positioned along the corneal flap hinge once this is lifted. It provides adequate protection to the epiflap during the procedure

Buratto J2186.4



Pinza per sollevamento del flap corneale con dischi atraumatici leggermente zigrinati
 Corneal flap forceps, angled, with atraumatic, disc-shaped tips



Buratto J2641.37



Buratto J2641.38



Cannula destra e sinistra per irrigazione epiflap corneale in tecnica LASIK, 5 fori di uscita. La cannula viene posizionata sotto il flap e con un'azione di movimento sul piano orizzontale effettua una perfetta idratazione

Right and left cannula for the irrigation of the corneal epiflap in LASIK. The 5 port cannula is positioned under the flap and with the aid of a moving action along the horizontal plane provides adequate irrigation

Slade J2641.44



Cannula per irrigazione flap corneale in tecnica LASIK, flautata, apertura sul fronte Ø 26 braccio da 12 mm leggermente angolato

LASIK Irrigating cannula, fluted-front opening, slightly curved, port Ø 26 gauge, 12 mm angle to tip



LASEK procedure



Vinciguerra J2294



Contenitore per soluzione alcolica con bassa suzione Ø 9.0 mm
Alcohol well with suction. Ø 9.0 mm



Janach JD2654

Siringa monouso con molla per suzione (da usare con J2294)
Single use vacuum syringe with spring (to be used with J2294)



Camellin J2900

Trapano epiteliale, tecnica LASEK. Ø 8.0 mm, con cerniera e profondità calibrata
Epithelial trephine, for LASEK procedure, Ø 8.0 mm, with hinge and calibrated depth J2901 Ø 9.0 mm



Shahinian J2907

Contenitore per soluzione alcolica, tecnica LASEK, Ø 9.0 mm
Alcohol well for LASEK procedure, Ø 9.0 mm J2908 Ø 10.0 mm



Camellin J2916A

Microzappa per scollare il bordo del flap epiteliale in periferia, tecnica LASEK, angolata, braccio ricurvo da 10 mm
Epithelial microhoe for LASEK procedure, angled, curved, 10 mm angle to tip. Useful to unstick the epithelium flap edges inside the groove



Camellin J2910A

Spatola per scollamento flap epiteliale, tecnica LASEK
Epithelial detaching spatula for LASEK procedure



Camellin J2920A

Spatola smussa per riposizionamento flap epiteliale, tecnica LASEK
Blunt spatula for repositioning of the epithelial flap for LASEK procedure



Camellin J2930A

Scollatore flap epiteliale, in tecnica LASEK. Inserito sotto il punto distale scolla il flap di epitelio sotto una leggera trazione lungo il piano orizzontale (dal punto distale alla cerniera)

Bow-dissector for LASEK procedure. Once positioned below the epithelial flap it allows to unstick the flap under a gentle pull on the horizontal plane (from the distal point to the hinge)



IRIS fixated IOL and ICL™ instruments



Aus Der Au J3864.1

★ most popular

Pinza coassiale per caricamento ICL™ con presa angolata

Coaxial forceps for ICL™ loading with angled tips



Buratto J3001

Holder coassiale per iniezione di IOL faticca pieghevole a fissazione iridea

Coaxial holder for enclavation of foldable iris-fixated phakic IOLs



Janach J3009.1

Pinza holder per IOL faticche a fissazione iridea

Phakic IOL holder



Janach J2174A

Posizionatore per IOL faticche a fissazione iridea

Phakic IOL manipulator



Janach J2175A

Doppio uncino per iniezione di IOL faticche a fissazione iridea

Double hook for enclavation of iris-fixated phakic IOLs



F. Carones J2186.50 right J2186.52 left

Pinza per impianto IOL pieghevole a fissazione iridea, branche lunghe

Implantation forceps for foldable iris-fixated IOL, long tip





Savaresi J2197.1A

Manipolatore per lenti ICL™, apice a disco piatto, atraumatico
ICL™ lens manipulator, flat atraumatic disc-shaped tip



Janach J2197.2A

Spatola angolata atraumatica, per posizionamento lente ICL™ in camera posteriore
Spatula, for positioning Visian Staar ICL™ lense



Janach J2197.3A



Spatola angolata atraumatica, con uncino smusso per per posizionamento lente ICL™ in camera posteriore
Atraumatic hook, for positioning Visian Staar ICL™ lense



Janach J3009.5

Pinza coassiale 23G per iridectomia con sistema di rotazione 360° del manico, con micropresa. Permette di eseguire una iridectomia periferica attraverso una paracentesi corneale di 0.6 mm

23G Coaxial iridectomy forceps, 360° rotating blunt microtips, for 0.6 mm corneal paracentesis (sideport incisions)
It allows to perform iridectomies through 0.6 mm corneal paracentesis



Crozafon® J2188.30


Pinza per caricamento IOL Alcon® AcrySof® Cachet™ nel cartridge, **branche cilindriche** da 11 mm

Foldable lens cartridge loading forceps (Alcon AcrySof® Cachet™) 11 mm angle to tip **cylindrical arms**




Janach J2199.12A

Doppia spatola per caricamento e posizionamento di IOL Alcon® AcrySof® Cachet™
IOL loading and positioning double-ended spatula (Alcon AcrySof® Cachet™)



FEMTOREFRACTIVE TOOLS

and NEWS for Smile[®] procedure



L. Mastropasqua M.D. Ph.D. J2192.37A

Disco-dissetto per apertura tasca intrastromale 1.5 mm, dorso leggermente curvo per procedura Smile[®]

Intrastromal pocket *dissector*, disk-shaped 1.5 mm, slightly curved, to open the intrastromal pocket in Smile[®] procedure



L. Mastropasqua M.D. Ph.D. J3158

Pinza per asportazione lenticolo stromale 3x2 denti retti, con azione verticale per procedura Smile[®]

Intrastromal forceps, vertical action to remove the stromal lenticle in Smile[®] procedure, 3x2 straight delicate teeth.



J2187.91: LASIK Flap Lifter and Positioner for SIM-LASIK with Kamra[®] Inlay

Strumento con duplice funzione. La pinza con apici a disco atraumatici permette di sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. La spatola di forma ad ansa consente un facile posizionamento del dispositivo Kamra[®] Inlay in tecnica SIM-LASIK.



This instrument has two functions. One side works as forceps to lift LASIK flap, and the other side works as spatula to correctly position the Kamra[®] Inlay for SIM-LASIK with Kamra[®] Inlay.

designed by MINORU TOMITA, M.D. Ph.D.



M. Tomita M.D. Ph.D.

J2180.91A: Hook for Kamra[®] Inlay implantation

Uncino smusso creato per aprire la tasca intrastromale dall'incisione facilitando l'introduzione del dispositivo Kamra[®] Inlay



This hook is to open the pocket sidecut and to lift the incision while inserting Dissector, Kamra[®] Inlay Inserting Forceps and Positioner.



M. Tomita M.D. Ph.D.

J2192.91A: Dissector for Kamra[®] Inlay implantation

Dissetto per tasca intrastromale. Il particolare design con curvatura e sottigliezza del dissetto consente una delicata dissezione della tasca evitando stress dell'incisione principale



Intrastromal pocket dissector. The unique design, curvature and thickness of this dissector allows comfortable dissection of the pocket without stressing the incision.

PRK photo refractive keratomy



Vinciguerra J2112A

Spatola per depitelizzazione per PRK Epithelium removal spatula, for PRK



Janach J2296.20

Doppio marcatore corneale per DSEK, Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm

Double-ended corneal marker for DSEK, Ø 8.0 mm, Ø 9.0 mm



LRI limbal relaxing incision diamond knife


bisturi in diamante per incisioni arcuate nel rilassamento limbare

Janach

J6800

J6801

J6804



singola profondità di taglio preselezionata

Lama retta a lancia tri-facet, double bevel, manico a baionetta in titanio

single cutting depth


Tri-facet lancet shaped blade, double bevel, titanium retractable handle

Order No	Cutting depth	B-B1	L	D	A
J6800	0.60	0.40-1.00	2.00	0.20	40°
J6801	0.65	0.40-1.00	2.00	0.20	40°
J6804	0.55	0.40-1.00	2.00	0.20	40°



Janach

J6807



tre profondità di taglio preselezionate

Lama retta a lancia tri-facet, double bevel, manico a baionetta con 3 profondità di taglio in titanio

three-preselectable cutting depths


Tri-facet lancet shaped blade, double bevel, 3 preset cutting depth, titanium retractable handle

Order No	Cutting depth	B-B1	L	D	A
ME707	0.50-0.55-0.60	0.40-1.00	3.00	0.10	20°



Zaldivar Buratto

J2292.11




Marcatore limbare per astigmatismo, Ø 11 mm, con marcature a 80° - 100° (Da utilizzare con J2295.5)

Arcuate incision marker, Ø 11 mm, markings at 80° - 100° (To be used with J2295.5)



Fazio

J2292.13




Marcatore limbare per astigmatismo, con marcature a 0° - 35° - 45° - 55°

Arcuate incision marker, markings at 0° - 35° - 45° - 55°



ACCESSORIES



Viscot™ V1425SR-10

Penna dermografica Viscot con punta doppia: ultra fine e media in confezioni da 10 pz. sterili
Double tip Viscot™ dermographic pen: ultra fine and medium, 10 per box, sterile



Janach J4491



Tamponi triangolari in PVA con manico,
conf. da 200 pezzi **sterili** in 20 buste da 10 pezzi
PVA spears with handle, box of 200 **sterile** items
20 packs with 10 spears



Janach J4493



Tamponi triangolari con manico,
conf. da 200 pezzi **sterili** in 20 buste da 10 pezzi
Triangular sponges with handle,
box of 200 **sterile** items,
20 packs of 10 sponges each



Janach J4496.1



Tamponi Viscotex, 5x66 mm. Confezione da 400 pz. **sterili** in 20 buste da 20 pz.
Viscotex sponges, 5 x 66 mm, box of 400 **sterile** items, 20 packs of 20 sponges

J4496.2

Tamponi Viscotex, 5x66 mm. Confezione da 500 pz. **non sterile**
Viscotex sponges, 5 x 66 mm, box of 500 pz. **non sterile**



Janach J4428



Protettore oculare trasparente post intervento, universale, **sterile**
Confezione da 100 pz.

Eye shield, clear, universal, **sterile**. To be sold in box of 100 units

J4428.0

Protettore oculare trasparente post intervento, universale, **non sterile**
Eye shield, clear, universal, **non sterile**. Individually packed

Sistema di
Qualità Certificato

Certified
Quality System

ISO 9001
ISO 13485

© Copyright:
Hermann Janach

BRO.033.03/13.EN

E. Janach S.r.l.
Via Borgo Vico, 35 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031 574088 - fax +39 031 572055
international@janach.it - www.janach.it